


手術顯微鏡 OPMI[®] pico With HD CAMERA



For dentistry

FULLHD
1080p



販売名: 手術顕微鏡 OPMI pico 製造販売届出番号: 13B1X00119003170



HDカメラ内蔵 OPMI pico

カールツァイスはHD（ハイディフィニション）カメラを内蔵することにより、さらに高解像度の映像を提供いたします。
1920×1080ドットのフルハイビジョン画像は、卓越したシャープさと鮮明度をそなえた画像が得られ、はるかに現実に近いビューアーがもたらされます。

手術顕微鏡 OPMI picoのHDカメラはカメラケーブルも顕微鏡スタンドに内蔵されることができ、従来の顕微鏡操作が損なわれない上、メンテナンスやクリーニングの面でもユーザーフレンドリーな構成を実現しています。

》》エルゴノミカルな設計


OPMI picoのHDカメラは内蔵タイプです。必要なケーブルはすべて OPMI picoの洗練された設計の中に納められています。これにより術者の移動自由度とエルゴノミクスを維持することができます。



HDカメラがコンパクトに内蔵されます。

》》ユーザーフレンドリーなワークフロー

OPMI picoのHDカメラヘッドとビデオレンズはシステムに内蔵されている為に、時間のかかる機械的調整が不要です。単に機器のスイッチを入れるだけで、すぐにお使い頂けます。各種設定もスタンドのカメラコントロールユニット（CCU）から簡単に操作できます。スタンドの構成により時間をかけることなく、最良の結果を得ることができます。

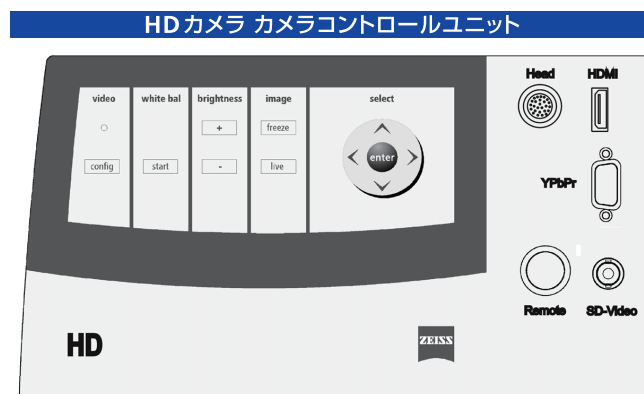

操作パネル及び接続端子概観図

OPMI pico HD カメラ フルハイビジョン / ハイビジョンの2機種		
	フルハイビジョン	ハイビジョン (720p)
解像度	1920×1080ピクセル	1280×720ピクセル
アスペクト	16:9	16:9
ビデオ規格	1080p, 1080i, 720p, NTSC (59.94Hz)	720p, NTSC (59.94Hz)
ズーム機能	電氣的ズーム機能	電氣的ズーム機能
出力形式		
HDMI出力	720p, 1080p, 1080i	720p
YPbPr (アナログコンポーネント出力)	720p, 1080i	720p
VBS (コンポジット出力)	NTSC	NTSC

製造販売元：

カールツァイスメディテック株式会社

〒160-0003

東京都新宿区本塩町22番地

Tel 03-3355-0331

Fax 03-3358-7413

URL <http://www.meditec.zeiss.co.jp>

発売元：

株式会社 ジーシー

東京都文京区本郷 3-2-14

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎ 0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支 店

●東 京(03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東 北(022)207-3370 ●九 州(092)441-1286