

一般医療機器 歯科用研磨器材

医療機器届出番号：15B1X10001090009

パールサーフェス Z

〔販売名〕パールサーフェス

*Pearl
Surface*



サイズの異なるダイヤモンド粒子を組み合わせ、 高い研磨性を実現したパールサーフェス Zが新発売!

Pearl Surface

パールサーフェス Z はジルコニア用研磨材です。フルジルコニアクラウンの研磨や、フレームのサポート形状部分の研磨に使用します。サイズの異なるダイヤモンド粒子を組み合わせ、高い研磨性を実現しました。研磨後は、滑沢で輝く面が得られます。またポーセレンなどガラス系材料やハイブリッドセラミックスの研磨にも最適です。

ノリタケカタナ ジルコニアによるフレーム、クラウン製作の流れ

● パールサーフェス Zの研磨概要 ※ご使用に際しましては、添付文書を必ずお読みください。



Step 1

ノリタケプロテック
ダイヤモンドポイントDP-06



Step 2


ノリタケプロテック
ダイヤモンドポイントSC-51



Step 3



パールサーフェス Z

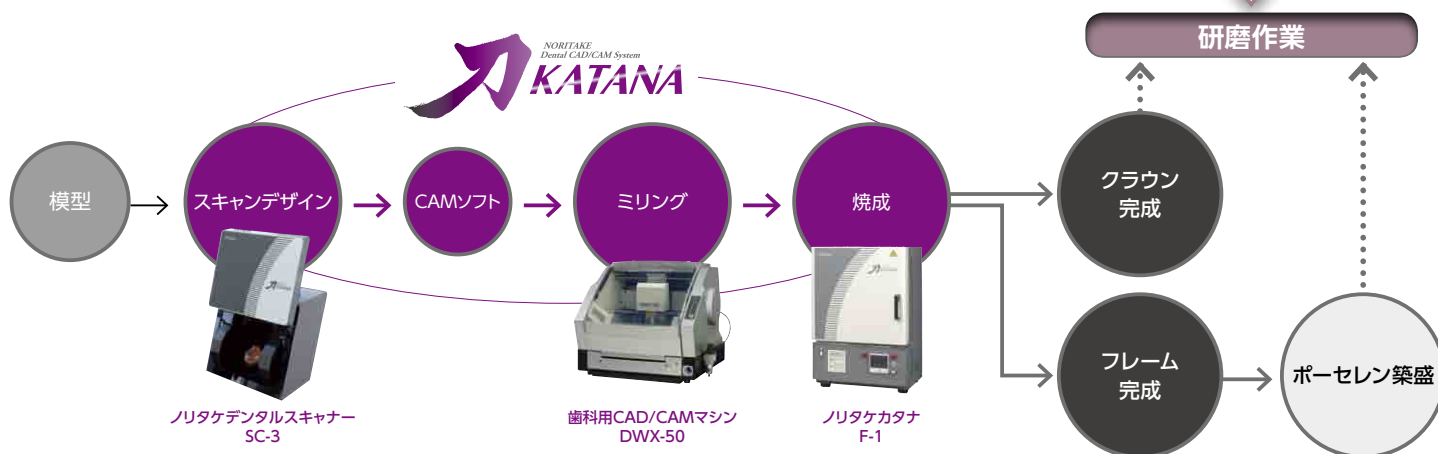

パールサーフェス

一般医療機器 歯科用研磨材
医療機器届出番号：15B1X10001090009

[単品] パールサーフェス Z

容量：20 g
メーカー希望小売価格 **6,500 円**
228514



その他の構成品

パールサーフェス セット ▶▶▶ メーカー希望小売価格 **5,200 円 228510**
パールサーフェス C (中仕上げ用) 1kg
パールサーフェス F (仕上げ用) 200g
フェルトホイール 2枚
単品 ▶▶▶
パールサーフェス C (中仕上げ用) 1kg メーカー希望小売価格 **2,200円 228511**
パールサーフェス F (仕上げ用) 200g メーカー希望小売価格 **3,000円 228512**
フェルトホイール 6枚 メーカー希望小売価格 **2,400円 228513**



ノリタケデジタルスキャナーSC-3	一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット	医療機器届出番号:15B1X10001290003
歯科用CAD/CAMマシンDWX-50	一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット	医療機器届出番号:22B3X10006000020 [製造販売元]ローランドディー・ジー・株式会社 / 静岡県浜松市北区新都田1-1-3
ノリタケカタナF-1	一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉	医療機器届出番号:25B2X10003000008 [製造販売元]SKメディカル電子株式会社 / 滋賀県長浜市七条町305-1
ノリタケプロテックダイヤモンドポイント	一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材	医療機器届出番号:09B1X00006018010 [製造販売元]マニー株式会社 / 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3
ノリタケカタナジルコニア	管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス	医療機器認証番号:223AFBZX00185000

●メーカー希望小売価格の後の6ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。●掲載商品のメーカー希望小売価格は2013年1月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。
●印刷のため実際の色調と異なる場合があります ●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

》クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

☎ 0120-330-922 月曜～金曜 10:00～17:00 www.kuraraynoritake.jp

製造販売元	クラレノリタケデンタル株式会社 〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28	販売元	株式会社モリタ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.(06)6380-2525 〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL.(03)3834-6161 http://www.dental-plaza.com
連絡先	クラレノリタケデンタル株式会社 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル) フリーダイヤル:0120-330-922		