THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

# BOSTOME

## Series

# BOS Bone Pick NEW

## BOS Bone Pick Bone Spreaderにて対応が困難な骨幅が狭いケースに適応

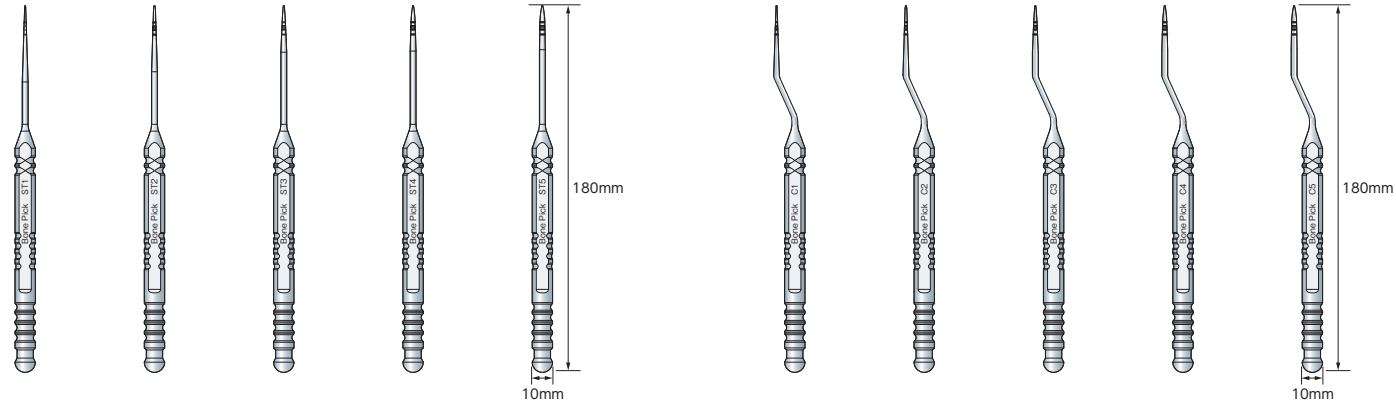


ST1　ST2　ST3　ST4　ST5　　C1　C2　C3　C4　C5

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOS ボーンピック ST1 | CDR00720 | 各14,000円 |
| BOS ボーンピック ST2 | CDR00721 | |
| BOS ボーンピック ST3 | CDR00722 | |
| BOS ボーンピック ST4 | CDR00723 | |
| BOS ボーンピック ST5 | CDR00724 | |

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOS ボーンピック C1 | CDR00725 | 各16,000円 |
| BOS ボーンピック C2 | CDR00726 | |
| BOS ボーンピック C3 | CDR00727 | |
| BOS ボーンピック C4 | CDR00728 | |
| BOS ボーンピック C5 | CDR00729 | |

[BOS外科手術用器具　届出番号:27B1X00047103101 ]

### ■ 先端サイズ

（単位:mm）

| 骨内長 | ST1 / C1 | ST2 / C2 | ST3 / C3 | ST4 / C4 | ST5 / C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.00 | 1.32 | 1.60 | 2.00 | 2.40 |
| 10 | 1.13 | 1.45 | 1.77 | 2.12 | 2.47 |
| 12 | 1.26 | 1.58 | 1.95 | 2.25 | 2.55 |
| 14 | 1.39 | 1.71 | 2.12 | 2.37 | 2.62 |

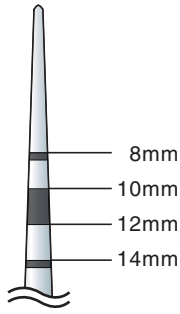


## Surgical Procedure

### 例:37-TPの場合

ステップ1：皮質骨穿孔



〔バリオサージチップ:SG15A or SG15C推奨〕

ステップ2：皮質骨拡大

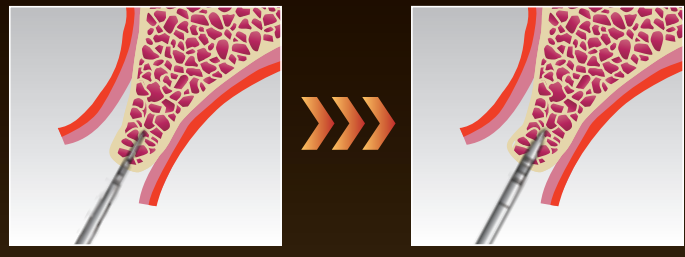

Bone Pick#1～5を用いて、順次拡大

ステップ3：骨幅拡大

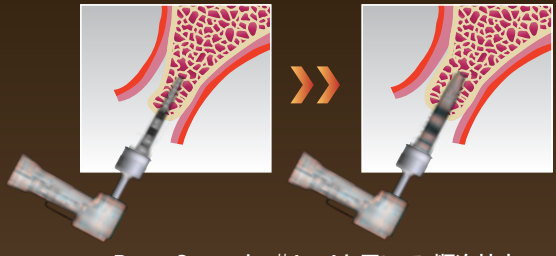

Bone Spreader#1～4を用いて、順次拡大

ステップ4：タップ形成



Screw Former

ステップ5：埋入



フィクスチャー埋入

# BOS Bone Operating Tool

## BOS Ridge Mapping Gauge 歯肉を貫通させて骨幅を計測するためのインスツルメント

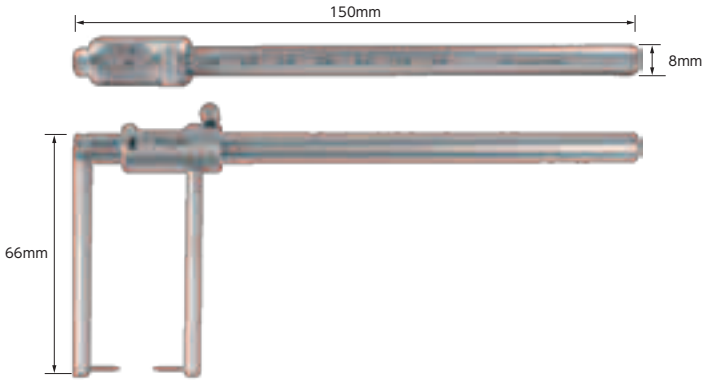


| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSリッジマッピングゲージR | CDR00701 | 17,440円 |

[製造販売届出番号:27B1X00047101115]

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

## BOS Implant Gauge 隣在歯との距離やフィクスチャー間の距離を計測するためのインスツルメント

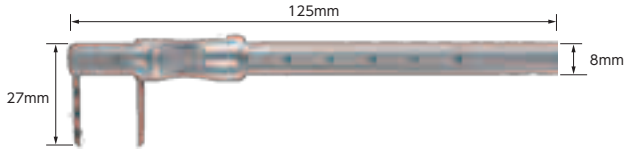


| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSインプラントゲージ | CDR00700 | 15,840円 |

[製造販売届出番号:27B1X00047101115]

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

## BOS Root Elevator 必要に応じてチップ交換ができる、抜歯用のインスツルメント

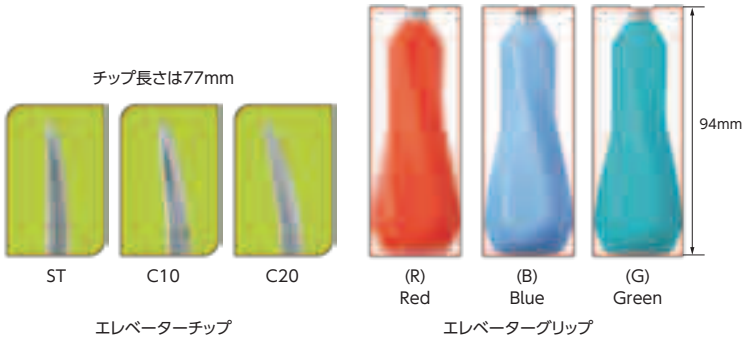


| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| エレベーターチップST | CDR00705 | 各2,800円 |
| エレベーターチップC10 | CDR00706 | |
| エレベーターチップC20 | CDR00707 | |
| エレベーターグリップ(R)* | CDR00708 | 各5,600円 |
| エレベーターグリップ(B) | CDR00709 | |
| エレベーターグリップ(G)* | CDR00710 | |

[製造販売届出番号:27B1X00047101115]

*エレベーターグリップ(R)、(G)は受注生産です。

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSルートエレベーター | CDR00704 | 13,440円 |

セット内容:エレベーターグリップ(B)、チップ3種類、チップ取外し用レンチ

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

## BOS Bone Spoon Packer 骨の運搬および充填に使用します。

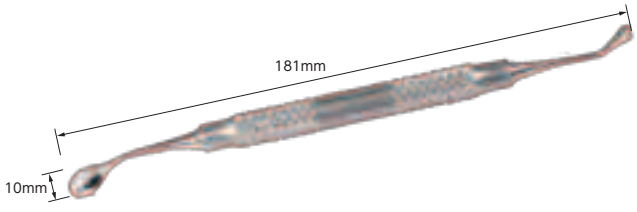


| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSボーンスプーンパッカー | CDR00703 | 12,160円 |

[製造販売届出番号:27B1X00047101115]

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

# BOS Bone Operating Tool

## BOS Bone Crester スプリットクレスト用インスツルメント

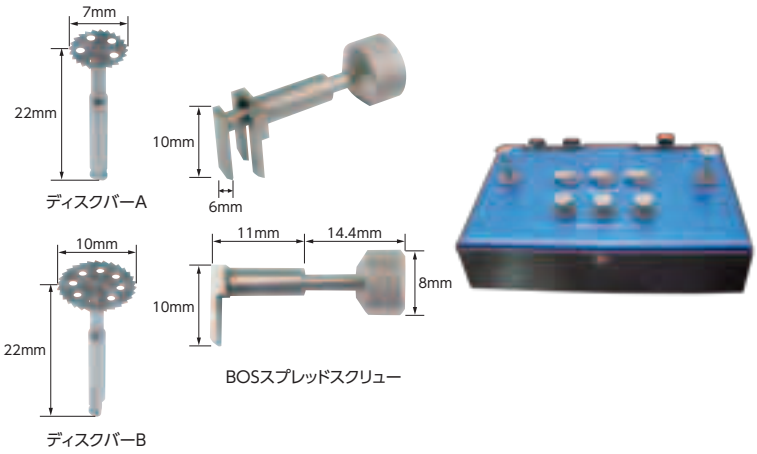


| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| ディスクバーA | CDR00676 | 各7,840円 |
| ディスクバーB | CDR00677 | |
| BOSスプレッドスクリュー | CDR00678 | 10,400円 |

[製造販売届出番号:27B1X00047103103]

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSボーンクレスターセット | CDR00675 | 47,840円 |

セット内容:ディスクバーAとB、BOSスプレッドスクリュー3本、BOSクレスターケース

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSクレスターケース | CDR00679 | 9.600円 |

※掲載価格はケース本体のもので、収納されている器具の価格は含まれておりません。

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

## BOS Split Chisel スプリットクレスト用インスツルメント

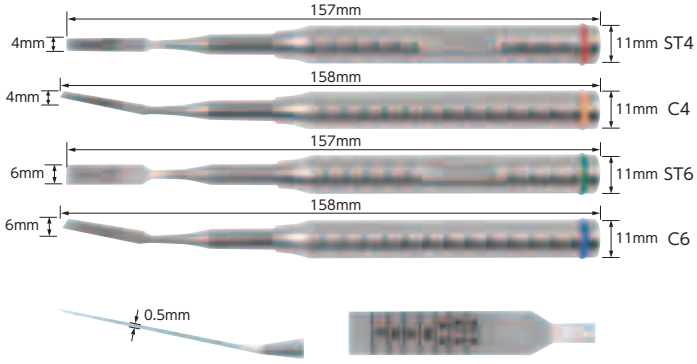


| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSスプリットチゼルST4 | CDR00671 | 各10,000円 |
| BOSスプリットチゼルC4 | CDR00672 | |
| BOSスプリットチゼルST6 | CDR00673 | |
| BOSスプリットチゼルC6 | CDR00674 | |

[製造販売届出番号:27B1X00047103103]

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSスプリットチゼルセット | CDR00670 | 31,840円 |

セット内容:BOSスプリットチゼルST4/C4/ST6/C6の4本組

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

## Surgical Procedure

1. ディスクバーで歯槽骨に切込みを入れる

2. ディスクバーで頬側に縦に切込みを入れる

3. チゼルで海綿骨に切込みを入れ、深度を決める※

4. スプレッドスクリューで歯槽骨を拡げる

5. フィクスチャーを埋入

6. スペースに採取骨や、骨補填材を填入

※ 深度を決める際は、埋入するフィクスチャーの骨内長よりも若干深く設定して下さい。

# BOS Bone Operating Tool

## BOS Gold Mill 採取した骨片を破砕するインスツルメント

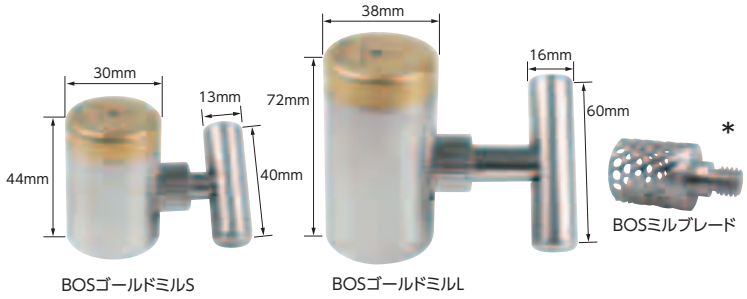


| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSゴールドミルS | CDR00684 | 55,840円 |
| BOSミルブレードS* | CDR00685 | 12,000円 |
| BOSゴールドミルL | CDR00682 | 63,840円 |
| BOSミルブレードL* | CDR00683 | 13,600円 |

[製造販売届出番号:27B1X00047103102]

*BOSミルブレードは、骨を削る刃部のみの販売です。

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

## BOS Bone Well 採取骨や骨補填材をブレンド/一時保管する際に用います。

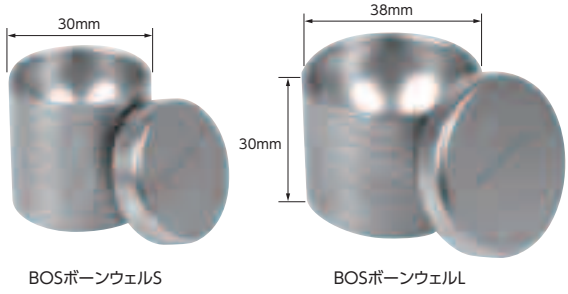


| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSボーンウェルS | CDR00680 | 6,000円 |
| BOSボーンウェルL | CDR00681 | 7,200円 |

[製造販売届出番号:27B1X00047103102]

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

## BOS Bone Carrier 採取骨や骨補填材の受床部位への填入に用いるインスツルメント

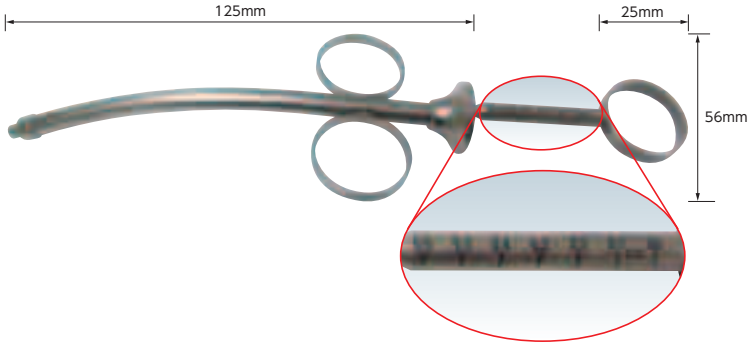


| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSボーンキャリアー | CDR00686 | 15,840円 |

[製造販売届出番号:27B1X00047103102]

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

## BOS Bone Scraper 皮質骨表層部を削るように剥り、自家骨を採取するインスツルメント

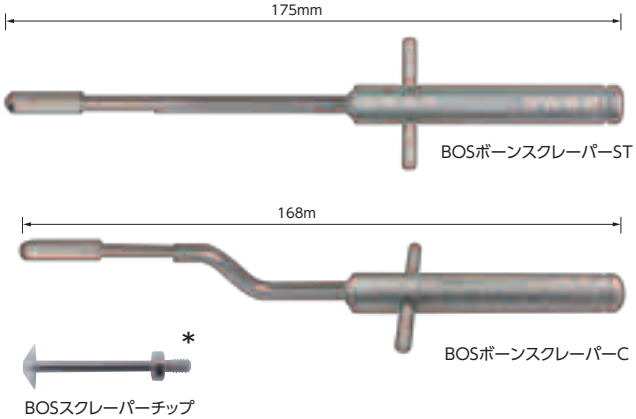


| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSボーンスクレーパーST | CDR00687 | 18,400円 |
| BOSボーンスクレーパーC | CDR00689 | 19,200円 |
| BOSスクレーパーチップ* | CDR00688 | 4,800円 |

[製造販売届出番号:27B1X00047103102]

*BOSスクレーパーチップは、BOSボーンスクレーパーの先端部のみの販売です。(ST・C共用)

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

# BOS Bone Spreader

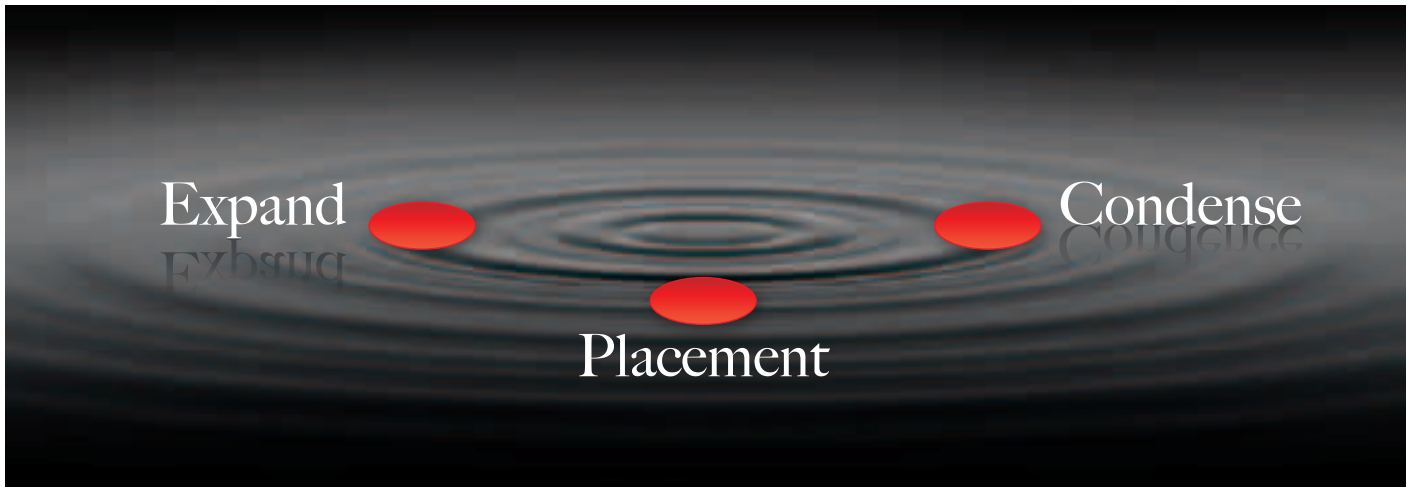


## BOS Bone Spreader 少ない衝撃で骨を押し拡げながら「脆弱骨の緻密化」・「骨幅の拡幅」を行う際に用います。

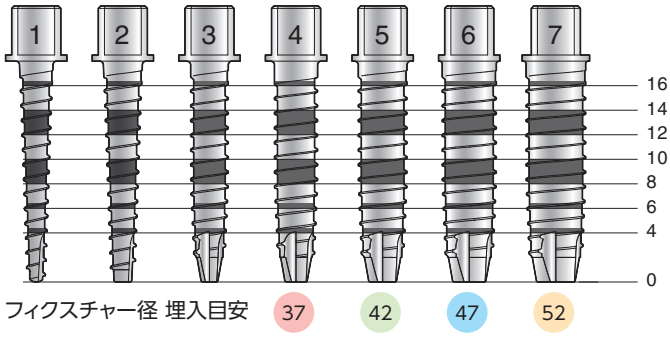


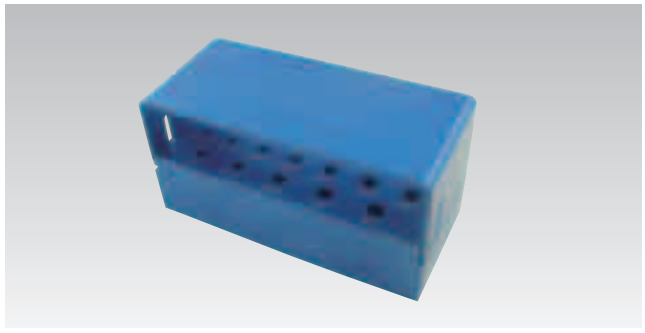

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSボーンスプレッダーセット (#1～#5の5本セット) | CDR00650 | 49,800円 |

※(単品合計60,000円)

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSスプレッダーケース | CDR00658 | 16,000円 |

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSボーンスプレッダー#1 | CDR00651 | 各12,000円 |
| BOSボーンスプレッダー#2 | CDR00652 | |
| BOSボーンスプレッダー#3 | CDR00653 | |
| BOSボーンスプレッダー#4 | CDR00654 | |
| BOSボーンスプレッダー#5 | CDR00655 | |
| BOSボーンスプレッダー#6 | CDR00656 | |
| BOSボーンスプレッダー#7 | CDR00657 | |

※#6、#7についてはオプション

[医療機器届出番号:27B1X00047101106]

### ■ φSize (Head & Body)

(単位:mm)

| 径 | 骨内長 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ (head) | - | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| φ (body) | 8 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 4.9 |
| | 10 | 2.2 | 2.6 | | | | | |
| | 12 | 2.3 | 2.8 | | | | | |
| | 14 | 2.5 | 2.9 | | | | | |
| | 16 | 2.6 | 3.1 | | | | | |

### ■ Design

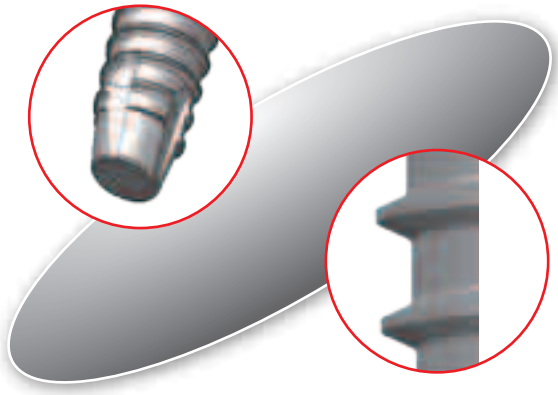

# BOS Bone Spreader

## Surgical Procedure

Provided by Dr.Tetsuji Takahashi

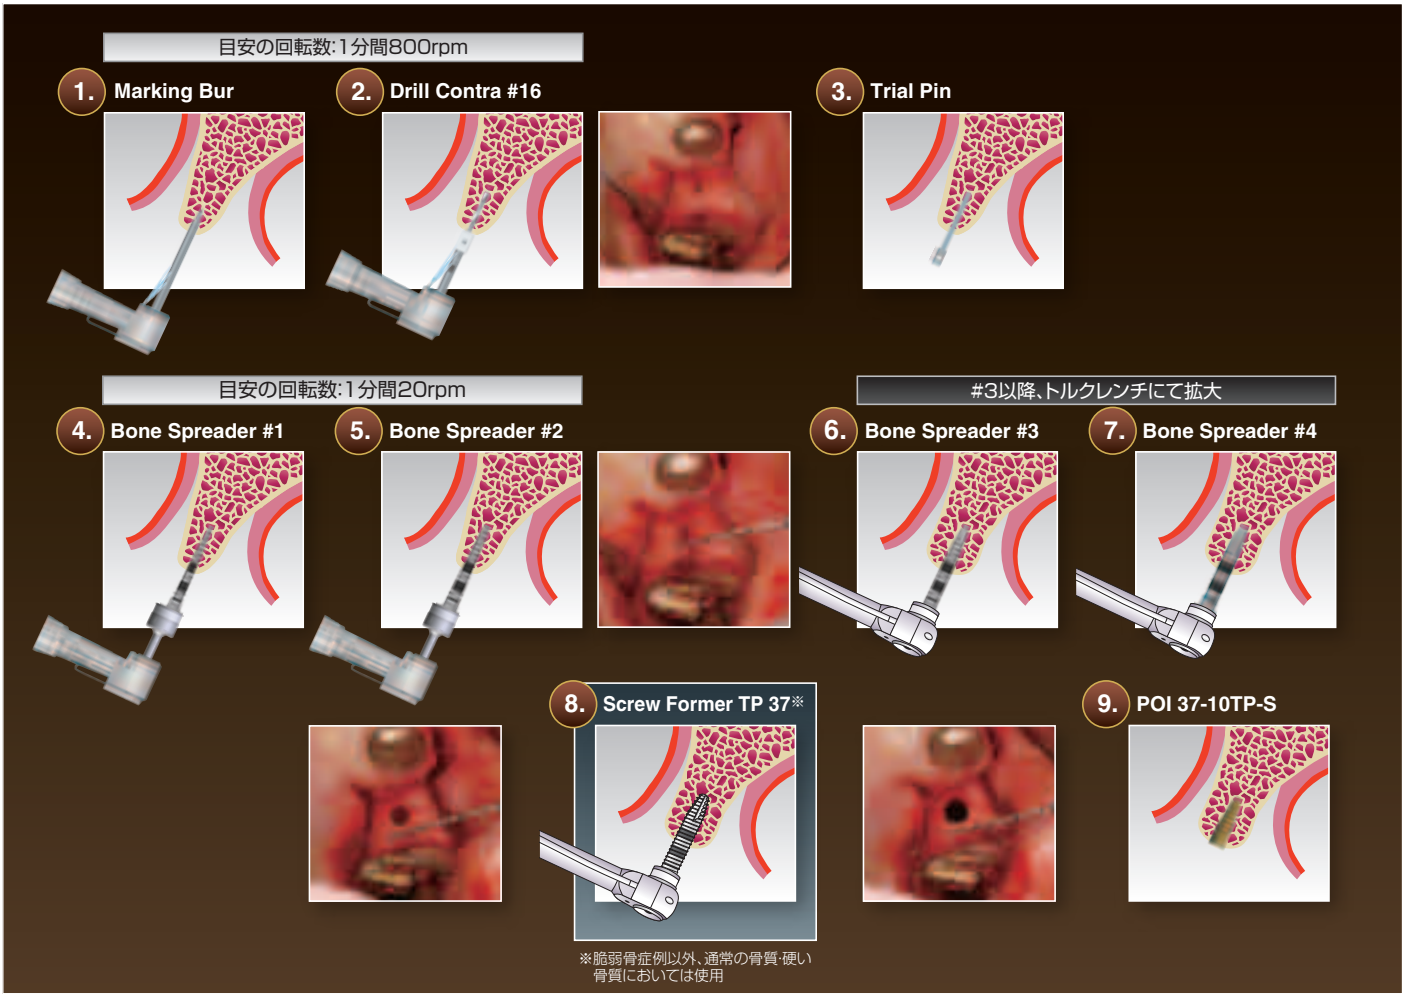


### ■ Easy Starter kit（希望小売価格199,800円）

| | 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| | BOS ボーンスプレッダーセット | CDR00650 | 49,800円 |
| | BOS スプレッダーケース | CDR00658 | 16,000円 |
| ※ | マーキングバー | CDI04920 | 10,000円 |
| ※ | ドリルコントラ#16−S | CDI02916 | 4,500円 |
| ※ | ストッパーリング#3セット | CDI03150 | 2,000円 |
| ※ | ストッパーリング#5セット | CDI03160 | 2,000円 |
| ※ | ストッパーリング#7セット | CDI03170 | 2,000円 |

| | 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| ※ | トライアルピンS | CDI02970 | 3,000円 |
| ※ | スクリューフォーマーTP37−S(N) | CDI04125 | 15,000円 |
| ※ | スクリューフォーマーTP42−S(N) | CDI04135 | 15,000円 |
| ※ | EXトルクレンチセット | CDI06290 | 55,000円 |
| ※ | ドライバーホルダーC-S | CDI05110 | 15,000円 |
| ※ | ドライバーホルダーC リング | CDI05130 | 3,500円 |
| ※ | フレックスドライバーCH S | CDI05092 | 7,000円 |

※POI EXシステム用インスツルメントです。

### ■ Option Tool

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| スクリューフォーマーTP47-S(N) | CDI04145 | 15,000円 |
| スクリューフォーマーTP52-S(N) | CDI04155 | 15,000円 |
| ドライバーエクステンダー(RN) | CDI03085 | 18,000円 |
| インプラントドライバー | CDI05140 | 30,000円 |
| ドライバーホルダー(N) | CDI03070 | 23,000円 |

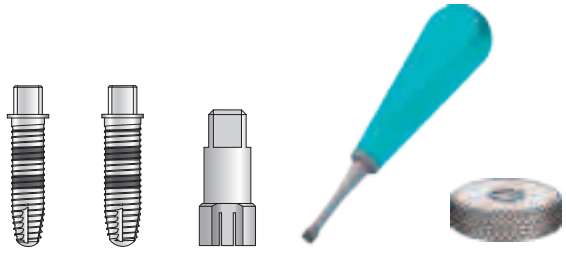

# BOS Trephine Kit

## BOS Trephine Kit 骨採取やフィクスチャー抜去、インプラント窩形成に用います。

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| アダプタドライバー* | CDI06550 | 5,800円 |
| ボーンプッシャー* | CDI06555 | 5,800円 |
| マーキングシャフト* | CDI06560 | 10,500円 |
| ストッパーシャフト#16* | CDI06565 | 各8,900円 |
| ストッパーシャフト#14 | CDI06570 | |
| ※ ストッパーシャフト#12 | CDI06575 | |
| ストッパーシャフト#10 | CDI06580 | |
| ストッパーシャフト#8 | CDI06585 | |
| ストッパーシャフト#6 | CDI06588 | |
| BOSトレフィンバー#1 | CDI06590 | 各9,900円 |
| BOSトレフィンバー#2 | CDI06595 | |
| BOSトレフィンバー#3* | CDI06600 | |
| BOSトレフィンバー#4* | CDI06605 | |
| BOSトレフィンバー#5* | CDI06610 | |
| BOSトレフィンバー#6* | CDI06615 | |

[医療機器届出番号:27B1X00047104106]

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSトレフィンベーシックキット | CDI06625 | 59,800円 |

*印がベーシックキットのセット内容になります。 (単品合計70,600円)

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSトレフィンケース | CDI06620 | 16,000円 |

掲載価格はケース本体のもので、収納されている器具の価格は含まれておりません。

※マーキングシャフト、ストッパーシャフトについて、お使いのマイクロモーターのコントラヘッド【ヘッド内寸法】が12mm以上ある場合は下記サイズをご使用ください。

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| マーキングシャフトL | CDI06561 | 10,500円 |
| ストッパーシャフト#16L | CDI06566 | 各8,900円 |
| ストッパーシャフト#14L | CDI06571 | |
| ストッパーシャフト#12L | CDI06576 | |
| ストッパーシャフト#10L | CDI06581 | |
| ストッパーシャフト#8L | CDI06586 | |
| ストッパーシャフト#6L | CDI06589 | |

[医療機器届出番号:27B1X00047104106]

## System Configration

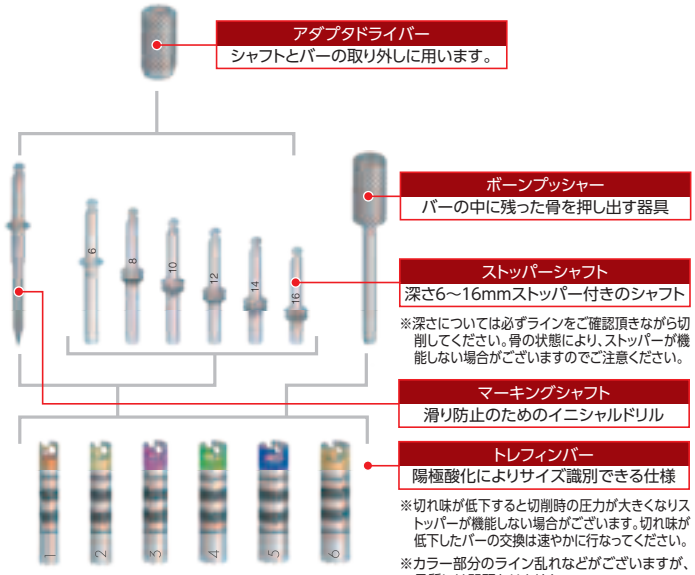


## Trephine Size

| | Tr#1 | Tr#2 | Tr#3 | Tr#4 | Tr#5 | Tr#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
| Outer | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
| Color | Brown | Yellow | Pink | Green | Blue | Gold |

## Surgical Procedure

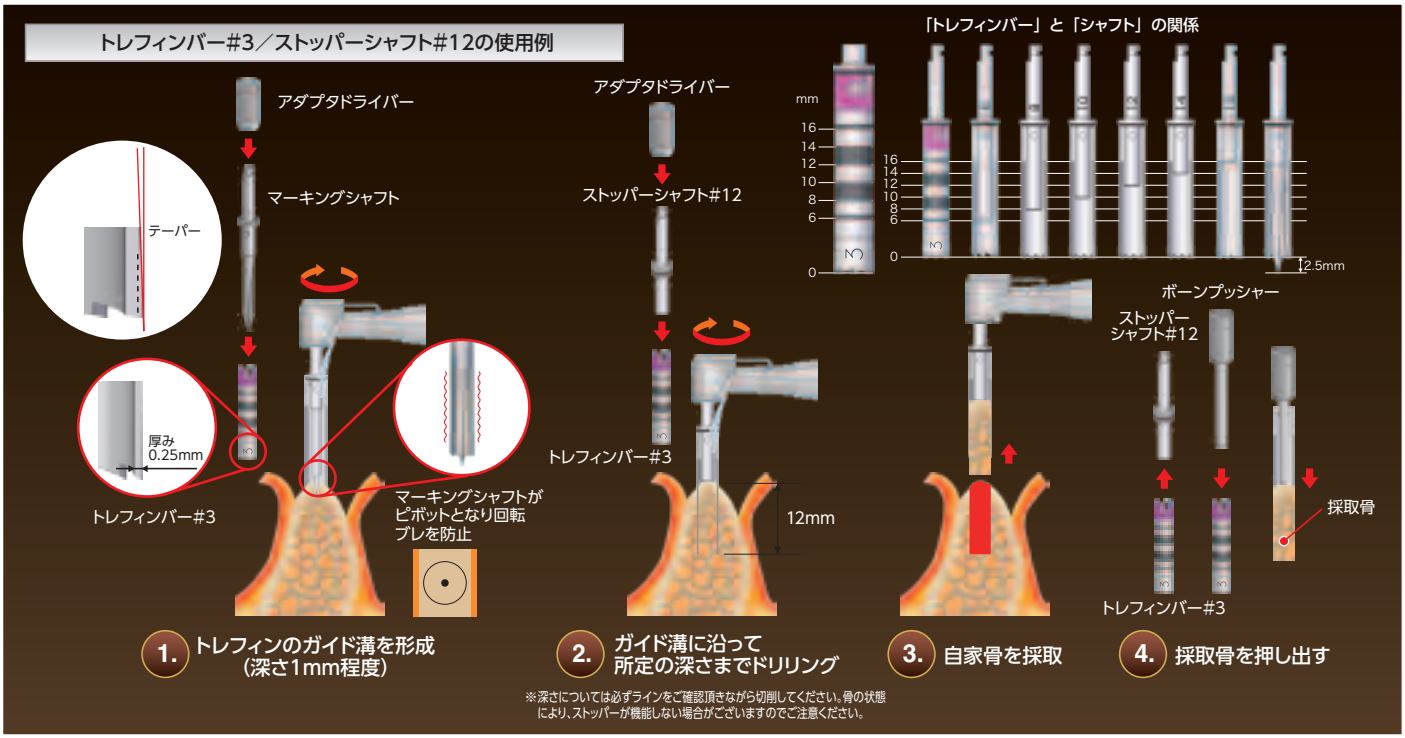

# Bostome

## Osteotome 先端形状 凹形状

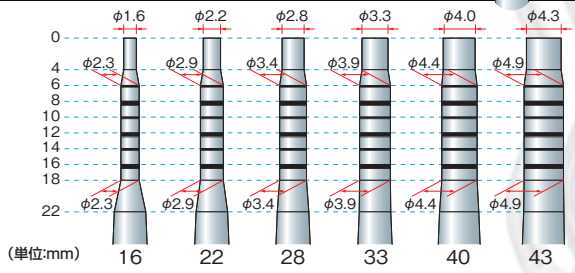


## Ridge Expander 先端形状 球形状

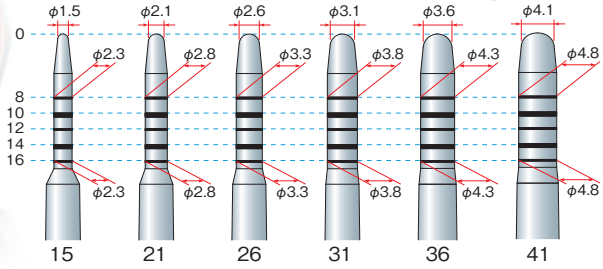


## Osteotome 歯槽骨頂部から上顎洞底までの垂直的な骨の厚みが薄い場合に行う、上顎洞底挙上術(ソケットリフト)に用います。

| ストレート・タイプ | 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| | BOSオステオトーム2-16S | CDR00150 | 各14,000円 |
| | BOSオステオトーム2-22S | CDR00160 | |
| | BOSオステオトーム2-28S | CDR00170 | |
| | BOSオステオトーム2-33S | CDR00180 | |
| | BOSオステオトーム2-40S | CDR00182 | |
| | BOSオステオトーム2-43S | CDR00184 | |

| カーブド・タイプ | 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| | BOSオステオトーム2-16C | CDR00250 | 各16,000円 |
| | BOSオステオトーム2-22C | CDR00260 | |
| | BOSオステオトーム2-28C | CDR00270 | |
| | BOSオステオトーム2-33C | CDR00280 | |
| | BOSオステオトーム2-40C | CDR00282 | |
| | BOSオステオトーム2-43C | CDR00284 | |

## Ridge Expander リッジエキスパンダーは、主に前歯部等で骨幅が唇、頬舌的に少ない場合、骨幅の拡幅を行う際に用います。

| ストレート・タイプ | 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| | BOSリッジエキスパンダ2-15S | CDR00050 | 各14,000円 |
| | BOSリッジエキスパンダ2-21S | CDR00060 | |
| | BOSリッジエキスパンダ2-26S | CDR00070 | |
| | BOSリッジエキスパンダ2-31S | CDR00080 | |
| | BOSリッジエキスパンダ2-36S | CDR00090 | |
| | BOSリッジエキスパンダ2-41S | CDR00100 | |

| カーブド・タイプ | 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| | BOSリッジエキスパンダ2-15C | CDR00350 | 各16,000円 |
| | BOSリッジエキスパンダ2-21C | CDR00360 | |
| | BOSリッジエキスパンダ2-26C | CDR00370 | |
| | BOSリッジエキスパンダ2-31C | CDR00380 | |
| | BOSリッジエキスパンダ2-36C | CDR00390 | |
| | BOSリッジエキスパンダ2-41C | CDR00400 | |

[医療機器届出番号:27B1X000471031101]

# Bostome-G

## Osteotome-G 先端形状 凹形状

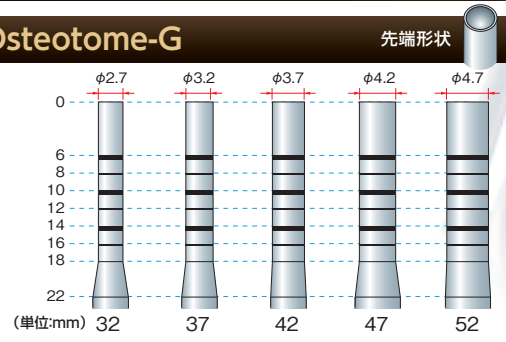


## Ridge Expander-G 先端形状 球形状

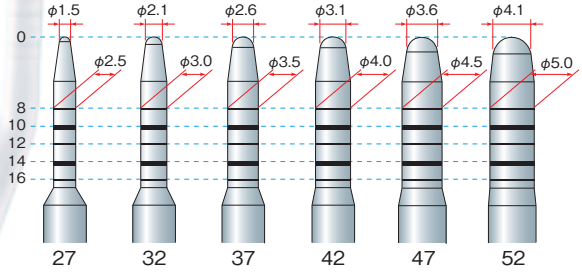


## Osteotome-G 歯槽骨頂部から上顎洞底までの垂直的な骨の厚みが薄い場合に行う、上顎洞底挙上術(ソケットリフト)に用います。

| | 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| | BOSオステオトームG-32C | CDR00188 | 各16,000円 |
| | BOSオステオトームG-37C | CDR00190 | |
| | BOSオステオトームG-42C | CDR00192 | |
| | BOSオステオトームG-47C | CDR00194 | |
| | BOSオステオトームG-52C | CDR00196 | |

## Ridge Expander-G 主に前歯部等で骨幅が唇、頬舌的に少ない場合、骨幅の拡幅を行う際に用います。

| | 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| | BOSリッジエキスパンダG-27C | CDR00540 | 各16,000円 |
| | BOSリッジエキスパンダG-32C | CDR00550 | |
| | BOSリッジエキスパンダG-37C | CDR00560 | |
| | BOSリッジエキスパンダG-42C | CDR00570 | |
| | BOSリッジエキスパンダG-47C | CDR00580 | |
| | BOSリッジエキスパンダG-52C | CDR00590 | |

[医療機器届出番号:27B1X000471031101]

## Bostome-IXY







| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOS サイナスキュレット IXY #1 | CDR00610 | 各15,000円 |
| BOS サイナスキュレット IXY #2 | CDR00620 | |
| BOS サイナスキュレット IXY #3 | CDR00630 | |
| BOS サイナスキュレット IXY #4 | CDR00640 | |

[医療機器届出番号:13B2X000940000003]
製造販売元:株式会社 デンテック

## Tool Case (ex. Bostome, Bostome-G, Bostome-IXY)

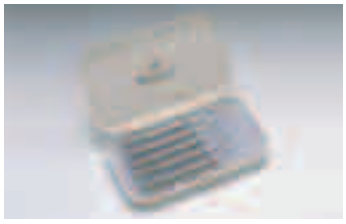

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| BOSツールケース | CDR00300 | 13,000円 |

※掲載価格はケース本体のもので、収納されている器具の価格は含まれておりません。
※オートクレーブ滅菌可能

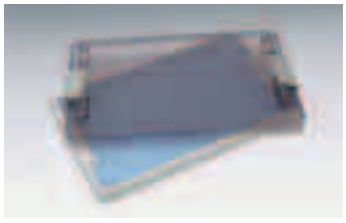

| 製 品 名 | 商品No | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| KMインスツルメントケース | CDR00812 | 21,000円 |

Ver.5.2


KYOCERA

京セラメディカル株式会社

大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル10F）〒532-0003

http://kyocera-md.jp/

京セラデンタルネット
www.kyocera-dental.com

商品に関するお問い合わせは下記の事業所・営業所まで

東京事業所　東京都新宿区西新宿2丁目4-1（新宿NSビル10F）〒163-0810　Tel:03-5339-3627　Fax:03-3343-3096

札幌営業所　札幌市中央区北一条西3丁目3（札幌MNビル9F）〒060-0001　Tel:011-555-3288　Fax:011-281-6525
名古屋営業所　名古屋市東区葵3丁目15-31（住友生命千種ニュータワービル6F）〒461-0004　Tel:052-930-1480　Fax:052-938-1388
大阪営業所　大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル8F）〒532-0003　Tel:06-6350-1007　Fax:06-6350-8157
岡山営業所　岡山市北区磨屋町10-16（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826　Tel:086-803-3625　Fax:086-225-2289
九州営業所　福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト7F）〒812-0013　Tel:092-452-8148　Fax:092-452-8177


VEGETABLE OIL INK


※このカタログは環境にやさしい植物油インキを使用しています。
■禁無断転載、複写



［2013年9月改訂］ 130925T S-285-7 010351